



## TMS- Porti onderzoek (controle)

*Informatie voor de patiënt bij een TMS-Porti onderzoek, die aangebracht wordt door de SAAS-verpleegkundige op de polikliniek voor slaapgeneeskunde. De volgende morgen wordt het onderzoek ook weer op de polikliniek verwijderd. Gelieve op de volgende punten te letten:*

- Dragen van comfortabele kleding of licht en loszittende kleding wordt sterk aanbevolen.
- Het aanbrengen van de draden en banden duurt ongeveer dertig minuten.
- De TMS-Porti is voorgeprogrammeerd. U hoeft niets aan of uit te zetten.
- Mochten er onverhoopt drukknopjes losgaan dan kunt u deze zelf weer bevestigen/vastdrukken.
- De volgende morgen worden op de polikliniek de sensoren en draden weer verwijderd.
- Contact met water moet vermeden worden.
- Voordat u gaat slapen moet de ademsensor tussen ademslang en masker aangebracht worden. (Zie foto met getal 7).
- Vergeet niet uw TMS-Porti-dagboek in te vullen.

### Belangrijke informatie

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan onze polikliniek, uw CPAP-apparaat én masker mee te nemen.

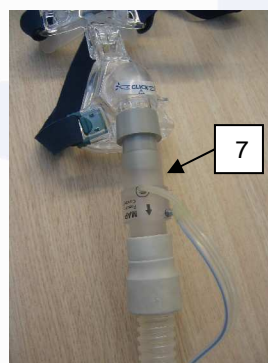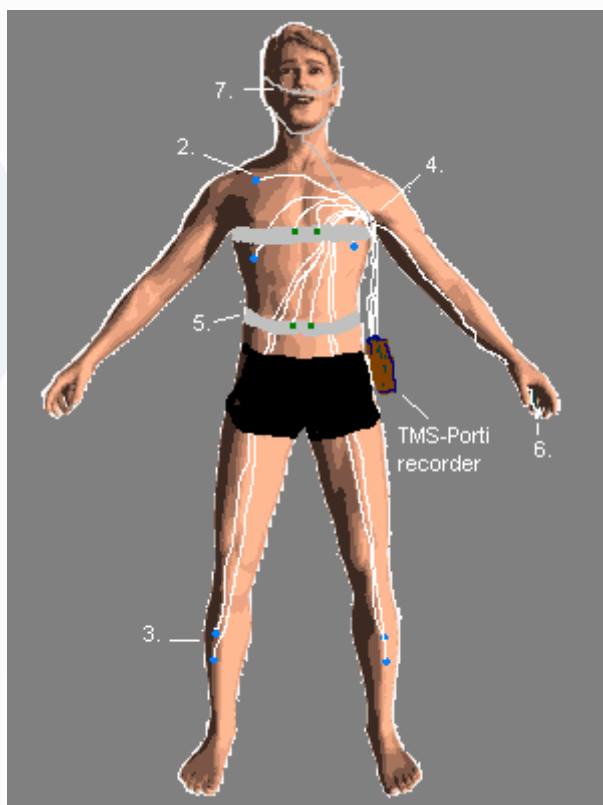

### De volgende draden worden bevestigd:

1. TMS-Porti recorder
2. ECG-elektrode
3. Bewegingssensoren
4. Borstband met positiemeter
5. Buikband
6. Sensor voor meten van zuurstofverzadiging in het bloed
7. Ademstroomsensor